

Bedienungsanleitung

METROTEC

Systeme zur Messung und Regelung von Sauerstoff

A15-N

Sauerstoff Sensor

Typreihe A15-N

*** Version 1.8 ***

EG-Konformitätserklärung

für

Sauerstoff Sensor Typreihe A15-N

Dieses Gerät ist vorgesehen für Anwendungen im Industriebereich nach:

EN 61000-6-4

EN 61000-6-2

Es ist konform zu den Richtlinien:

EMV Richtlinie: 2014/30/EU

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

RoHS: 2011/65/EU

Folgende Normen werden berücksichtigt:

EN 61010-1

EN 61000-6-4

EN 61000-6-2

EN 63000

Beschreibung der Maßnahmen zur Sicherstellung der Konformität:

Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, Nr. 12 100 27736 TMS

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Änderungen ohne unsere Zustimmung vorgenommen werden.



Kirchheim/Teck, 07.10.2019








Ort, Datum

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

| | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | SICHERHEITSHINWEISE | 4 | ZUSAMMENBAU | 11 | |
| 2 | EINLEITUNG | 5 | 4.5 ELEKTRISCH | 11 | |
| 3 | MESSPRINZIP | 6 | 4.6 MECHANISCH | 12 | |
| 4 | AUFBAU..... | 7 | 5 | OPTIONEN..... | 12 |
| 4.1 | SENSOR | 7 | 6 | VERDRAHTUNGSPLAN | 13 |
| 4.2 | UMSETZERMODUL Z15..... | 8 | 7 | TECHNISCHE DATEN | 14 |
| 4.3 | UMSETZERMODUL Z15-L/ -LP .. | 9 | | | |
| 4.4 | UMSETZERMODUL U15 | 10 | | | |

1 Sicherheitshinweise

| | |
|---|--|
|  | Bitte lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Unsachgemäßer Gebrauch schließt jegliche Gewährleistung aus! |
|  | Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit des Gerätes ist nur unter den Umgebungsbedingungen, die im Kapitel Technische Daten spezifiziert sind gewährleistet. |
|  | Das Gerät darf nur von qualifiziertem und geschultem Personal in Betrieb gesetzt und bedient werden. Der Betreiber des Gerätes muss sicherstellen, dass entsprechende Gesetze und Richtlinien beachtet werden. Dies sind unter anderen z.B. EG-Richtlinien zum Arbeitsschutz, nationale Gesetze zum Arbeitsschutz, Unfallverhütungsvorschriften etc. |
|  | Es ist sicherzustellen, dass die Versorgungsspannung mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt. Alle für den Berührungsschutz erforderlichen Abdeckungen müssen angebracht sein. Ist das Gerät mit anderen Geräten und/oder Einrichtungen zusammenschaltet, so sind vor dem Einschalten die Auswirkungen zu bedenken und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. |
|  | Es können bei oder nach der Installation oder Deinstallation fallweise heiße Teile oder Oberflächen frei liegen. Um Verletzungen oder Schaden zu vermeiden sind geeignete Vorkehrungen zu treffen. |
|  | Weist das Gerät Schäden auf, die vermuten lassen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht möglich ist, so darf das Gerät nicht in Betrieb gesetzt werden. Eine periodische Überprüfung im Werk oder durch den Kundendienst wird mindestens einmal pro Jahr empfohlen. |
|  | Eine eventuelle Entsorgung ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durchzuführen. |

2 Einleitung

Die Sauerstoff-Messgeräte und das Zubehör wurden unter Berücksichtigung einer durchgehenden Qualitätssicherung hergestellt und überprüft.

Der Einbau und der Einsatz darf nur unter Beachtung aller örtlichen und speziellen Vorschriften erfolgen. Dazu zählen insbesondere die VDE und DVGW.

Eine periodische Überprüfung der Messeinrichtung auf Messgenauigkeit und Funktion ist je nach Einsatzfall erforderlich und muss im Rahmen einer Eich- und Überprüfungsanweisung nach der Erstinbetriebnahme durchgeführt werden.

3 Messprinzip

Sauerstoff-Messgeräte sind ausgelegt um Signale eines Sauerstoff - Sensors aus stabilisiertem Zirkondioxid zu verarbeiten. Das Zirkondioxid, eine Keramik, die auch als Festkörperelektrolyt bezeichnet wird, eignet sich bei höheren Temperaturen hervorragend als Sauerstoffionenleiter.

Solche Ionenleiter besitzen innerhalb eines bestimmten Temperaturbereiches, der von der Dotierung des Werkstoffes abhängig ist, die Fähigkeit Leerstellen in ihrem Kristallgitter mit Sauerstoffionen aufzufüllen. Die Sauerstoffionen entstehen an einer leitfähigen Kontaktschicht, die in der Regel aus Platin besteht.

Die Konzentration des Sauerstoffes in einem Messgas ist somit entscheidend für das Maß an Sauerstoffaktivität beziehungsweise der Anzahl an Sauerstoffionen.

Der prinzipielle Aufbau eines Sensors sieht einen Festkörperelektrolyten vor, der auf beiden Seiten kontaktiert ist. Die eine Seite des Elektrolyten wird mit einem Referenzgas, z.B. Luft betrieben, die andere Seite mit Messgas. Der mechanische Aufbau des Sensors trennt beide Gasseiten voneinander, sodass ein Vermischen der Gase unterbunden ist.

Je nach Einsatzfall werden beheizte oder unbeheizte Sensoren verwendet. Unbeheizte Sensoren werden überwiegend im Ofenbereich eingesetzt, beheizte Sensoren in jenen Anwendungsfällen, in denen Gase unter circa 600 Grad Celsius gemessen werden sollen. (Eine Mindesttemperatur von 500 - 650 Grad ist durch das Messprinzip bedingt.)

Beheizte Sensoren werden durch einen in der Verarbeitungselektronik eingebauten Temperaturregler auf eine bestimmte Solltemperatur eingeregelt. Die Temperatur von beheizten und unbeheizten Sensoren wird mittels der Elektronik gemessen und geht in die Berechnung des Sauerstoffgehaltes (Sauerstoff-Partialdruck) wesentlich mit ein.

Die Berechnung erfolgt nach der Formel:


$$EMK = \frac{R \cdot T}{4 \cdot F} \cdot \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

wobei gilt:

- R = 8.31J/mol K
- T = Temperatur in Kelvin
- F = 96493 As/mol
- P₁ = Sauerstoffpartialdruck auf der Referenzseite mit 0.20946 bar
- P₂ = Sauerstoffpartialdruck auf der Messgasseite
- EMK = Elektromotorische Kraft in Volt

4 Aufbau

4.1 Sensor

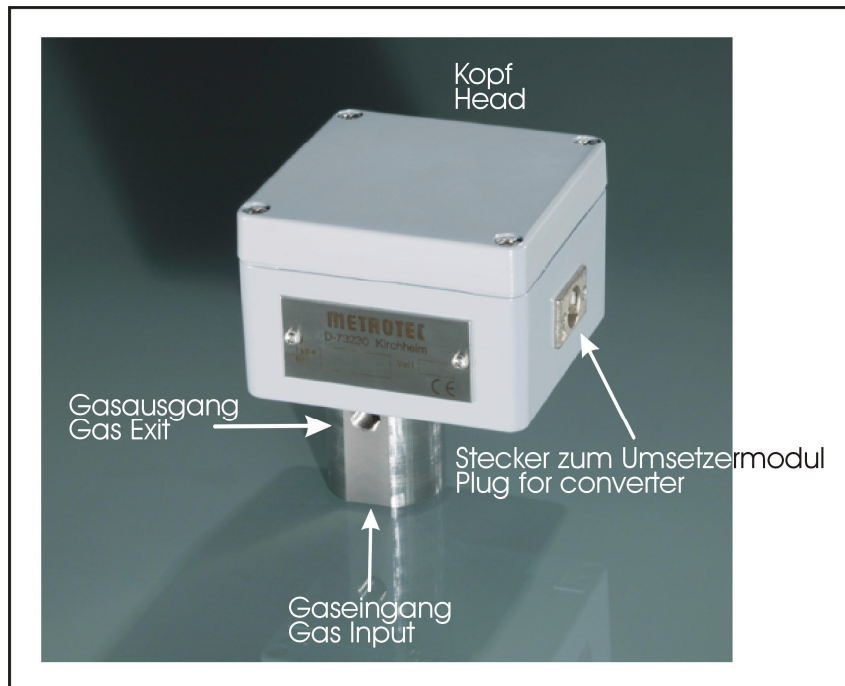


Sensor A15-N

Der Sensor ist in einem Edelstahlkörper eingebaut, der als Anschlusskopf ein Aluminium-Druckguss-Gehäuse mit Steckeranschluss besitzt.

Prinzipiell kann der Sensor in jeder Position montiert werden. Es empfiehlt sich aber eine Montage bei welcher der Anschlusskopf oben ist. Die Gaszuleitung befindet sich dann unten in der Vertikalachse, die Gasableitung horizontal im Edelstahlkörper. Beim Anschluss der Gasleitungen ist stets auf fallende Neigung der Leitungen vom Sensor weg zu achten, damit eventuell anfallendes Kondensat nicht in den Sensor laufen kann.

Im Anschlusskopf befindet sich ein Mehrpolstecker, an dem das Verbindungskabel zum Umsetzermodule angeschlossen wird.

4.2 Umsetzermodule Z15

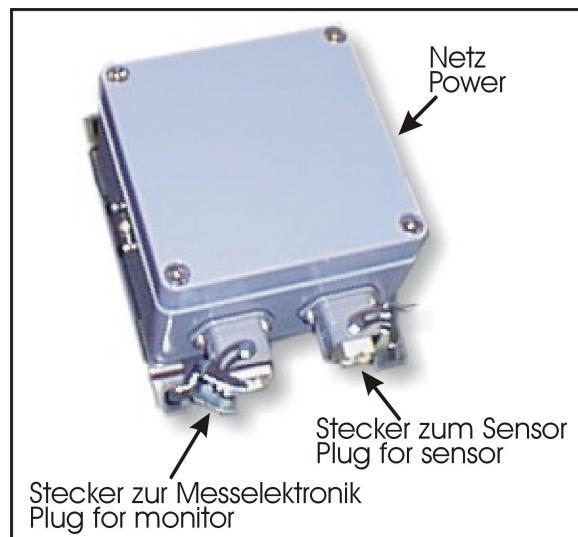


Umsetzermodule Z15

Der Umsetzermodule Typ Z15 ist in einem Aluminium-Druckguss-Gehäuse eingebaut, das mit Befestigungslaschen zur Wandmontage versehen ist. Ein Verbindungskabel zum Sensor Typ A15-N stellt die Beheizung und Signalübertragung sicher. Der zweite Stecker dient der Verbindung zu einer weiterverarbeitenden Elektronik. Zur Energieversorgung muss das integrierte Netzkabel an eine Steckdose eingesteckt oder an der Netzversorgung angeschlossen werden. (die Spannungen sind auf dem Typenschild vermerkt. Sie sind z.B. 230VAC, 115 VAC, 24 VDC)

Die eingebaute Elektronik beinhaltet die Beheizung des Sensors sowie die Signalaufbereitung nach der im Abschnitt Messprinzip beschriebenen Gleichung.

4.3 Umsetzermodule Z15-L/ -LP

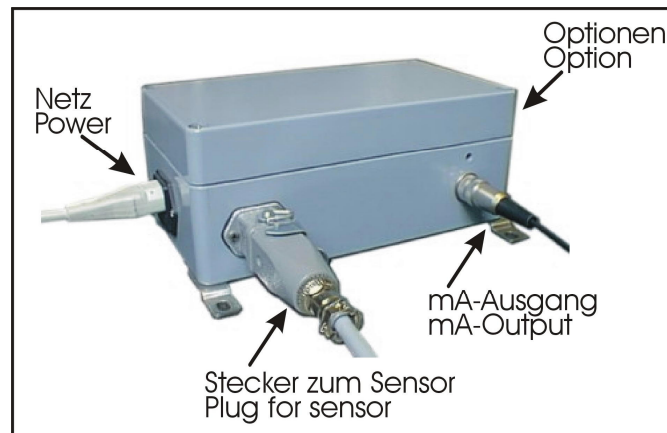

Umsetzermodule Z-15L/Z-15LP

Der Umsetzermodule Typ Z-15L/Z-15LP ist in einem Aluminium-Druckguss-Gehäuse eingebaut, das mit Befestigungslaschen zur Wandmontage versehen ist. Ein Verbindungskabel zum Sensor Typ A15-N stellt die Beheizung und Signalübertragung sicher. Zur Energieversorgung muss das Netzkabel in eine Steckdose gesteckt oder an der Netzversorgung angeschlossen werden.

Die eingebaute Elektronik beinhaltet die Beheizung des Sensors sowie eine Signalumformung. Diese setzt die im Abschnitt Messprinzip aufgeführte EMK in ein linearisiertes Milliampere-Signal um. Der Standardbereich beträgt 0 bis 20 mA für 0 bis 20% Sauerstoff.

Dieses Signal wird an der runden Buchse abgegriffen und einem Anzeigeelement, Regler oder Schreiber zu geführt. Der Standardbereich ist bewusst auf 0 bis 20 mA festgelegt, damit ein Normgerät den Milliampere-Wert genau als Prozent Sauerstoff abbildet. Dies erspart den Einsatz einer Sonderskala am Anzeiger, Regler oder Schreiber.


Als Variante sind Sondermessbereiche erhältlich.

Über dem Steckanschluss für den mA-Ausgang befindet sich ein Einstellpotentiometer mit dem ein Abgleich vorgenommen werden kann. Es wird dabei folgendes Vorgehen empfohlen:

1. Anschließen eines Eichgases am Sensor
2. Sensor mit Eichgas in der vorgeschriebenen Menge beaufschlagen
3. Abgleich des angezeigten Wertes mit dem Abgleichpotentiometer
4. Abtrennen des Eichgases
5. Verbindung zur Messgasleitung wieder herstellen.

Vor diesen Einstellungen sollte sichergestellt sein, dass die Sensor-EMK bei Luftspülung 0 mV beträgt. Mit einem Millivoltmeter, das an der Buchse Option an Stift 1 und 3 angeschlossen wird kann diese Spannung überprüft und mit dem darüber befindlichen Potentiometer auf Null abgeglichen werden.

4.4 Umsetzermodule U15

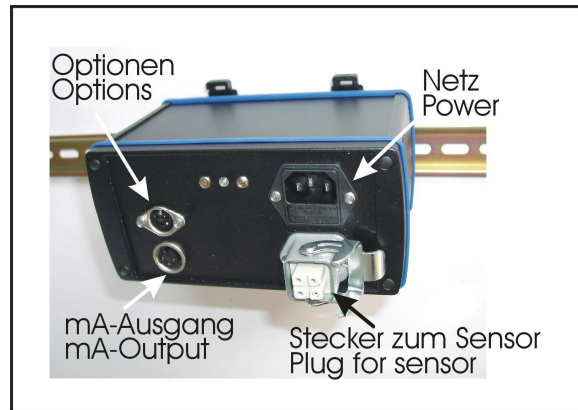

Umsetzermodule U15

Der Umsetzermodule Typ U15 ist in einem Aluminium-Druckguss-Gehäuse eingebaut, das für U-Schiene montiert vorgesehen ist. Ein Verbindungskabel zum Sensor Typ A15-N stellt die Beheizung und Signalübertragung sicher. Zur Energieversorgung muss der Kaltgeräteanschluss an der Netzversorgung angeschlossen werden.

Die eingebaute Elektronik beinhaltet die Beheizung des Sensors sowie eine Signalumformung. Diese setzt die im Abschnitt Messprinzip aufgeführte EMK in ein linearisiertes Milliampere-Signal um. Der Standardbereich beträgt 0/4 bis 20 mA für 0 bis 20% Sauerstoff.

Dieses Signal wird an der runden 3-poligen Buchse abgegriffen und einem Anzeigeinstrument, Regler oder Schreiber zu geführt. Der Standardbereich ist bewusst auf 0 bis 20 mA festgelegt, damit ein Normgerät den Milliampere-Wert genau als Prozent Sauerstoff abbildet. Dies erspart den Einsatz einer Sonderskala am Anzeiger, Regler oder Schreiber.

Als Variante sind Sondermessbereiche erhältlich.


Neben dem Steckanschluss für den mA-Ausgang befindet sich ein Einstellpotentiometer „Gain“ mit dem ein Abgleich vorgenommen werden kann. Es wird dabei folgendes Vorgehen empfohlen:

1. Anschließen eines Eichgases am Sensor
2. Sensor mit Eichgas in der vorgeschriebenen Menge beaufschlagen
3. Abgleich des angezeigten Wertes mit dem Abgleichpotentiometer
4. Abtrennen des Eichgases
5. Verbindung zur Messgasleitung wieder herstellen.


Vor diesen Einstellungen sollte sichergestellt sein, dass die Sensor-EMK bei Luftspülung 0 mV beträgt. Mit einem Millivoltmeter, das an der 5-poligen Buchse „Adjust“ an Stift 1 und 3 angeschlossen wird, kann diese Spannung überprüft und mit dem daneben befindlichen Potentiometer „Offset“ auf Null abgeglichen werden.

Zusammenbau

4.5 Elektrisch

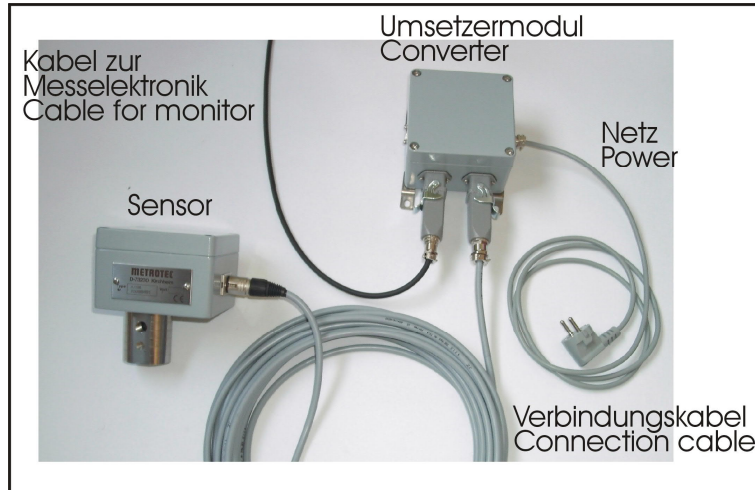

Verschaltung des Sensors A15-N mit dem Umsetzermodule Z15

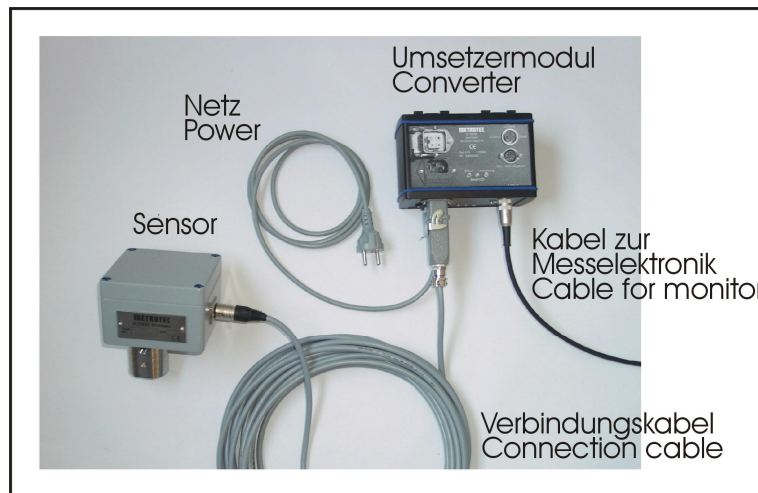

Verschaltung des Sensors A15-N mit dem Umsetzermodule U15

Der elektrische Zusammenbau ist durch vorkonfektionierte Kabel sehr einfach. Der Sensor wird mit dem Umsetzermodule verbunden.

Beim Umsetzermodule Z15 erfolgt eine Weiterverbindung zu der Verarbeitungselektronik mit Kabel.

Beim Umsetzermodule Z15-L und U15 wird nur das Ausgangssignal 0/4 bis 20 mA zu den peripheren Geraten weiterverbunden.

Die Netzversorgung ist am Umsetzermodule anzuschlieen.

4.6 Mechanisch

Der Sensor wird mit einem Verbindungsfitting mit der Anlage verbunden. In einigen Anwendungen mussen die Messgase durch Mauerwerk oder Isolation hindurch. Dabei bietet sich ein Entnahmerohr aus Metall oder Keramik an. Ein solches Rohr stellt sicher, dass erstens das Messgas an der gewunschten Stelle abgezogen wird und zweitens auf dem Weg zum Sensor keine Veranderung zum Beispiel durch Falschlucht eintritt.

Fur alle Falle in denen Kondensatbildung auftreten kann muss diese Leitung steigend zum Sensor verlegt werden und die Gasaustrittsleitung fallend vom Sensor weg.

Der andere Anschluss am Sensor wird mit der Stelle verbunden, an der die Abgase des Sensors einflieen. Diese Stelle muss gegenuber dem Gaseintritt einen geringeren Druck besitzen damit die Gase durch den Sensor vom Gaseintritt zum Gasaustritt flieen konnen.

Es gibt mehrere Moglichkeiten um einen Gasfluss zu erzwingen:

1. Der Uberdruck der Messgasseite wird ausgenutzt.
2. Ein Differenzdruck in der Anlage wird ausgenutzt. Wobei der Differenzdruck zwischen Gaseintritt und Gasaustritt des Sensors entstanden sein muss.
3. Eine Gaspumpe druckt oder saugt die Messgase durch den Sensor.

Bei all den beschriebenen Verfahren ist der Durchfluss durch den Sensor auf ca. 50 Liter pro Stunde zu halten.

Der Einbau eines Durchflussmessers und eines Nadelventils in die Gasleitungen kann hilfreich und erforderlich sein. Bei manchen Anwendungen ist eine Durchflussuberwachung zum Beispiel mit einem Durchflussmesser mit Grenzkontakten notwendig.

5 Optionen

Spezielle Messbereiche beim Umsetzermodule Z15-L, Z15-LP, U15:

Der Standardbereich ist 0 bis 20 mA bei 0 bis 20% Sauerstoffgehalt. Fur Anwendungen deren Arbeitsbereich zum Beispiel bei 1 % liegt ist die Messauflosung im Standardmessbereich ungenugend. Daher kann der Messbereich optional auf einen Messbereich von 0 bis 20 mA bei 0 bis 2% Sauerstoff eingestellt werden. Diese Option kann nur durch Werkseinstellung vorgenommen werden.

6 Verdrahtungsplan

Sensor A15-N

| | |
|-------|----------|
| Pin 1 | Sensor - |
| Pin 2 | Sensor + |
| Pin 3 | Heizung |
| Pin 4 | Heizung |

Umsetzermodule Z15; Kabel zum Sensor

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Steckereinsatz des Verbindungskabels | Stifte |
| Pin 1 | Heizung |
| Pin 2 | Heizung |
| Pin 3 | Sensor + |
| Pin 4 | Sensor - |

Umsetzermodule Z15; Kabel zur Messelektronik

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Steckereinsatz des Verbindungskabels | Buchsen |
| Pin 1 | Temperatur + |
| Pin 2 | Temperatur - |
| Pin 3 | Sensor + |
| Pin 4 | Sensor - |

Umsetzermodule Z15-L/LP; Kabel zum Sensor

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Steckereinsatz des Verbindungskabels | Stifte |
| Pin 1 | Heizung |
| Pin 2 | Heizung |
| Pin 3 | Sensor + |
| Pin 4 | Sensor - |

Umsetzermodule Z15-L/LP; Kabel für Ausgang

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Steckereinsatz des Verbindungskabels | Stifte |
| Pin 1 | mA Ausgang + |
| Pin 3 | mA Ausgang - |

Umsetzermodule U15; Kabel zum Sensor

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Steckereinsatz des Verbindungskabels | Stifte |
| Pin 1 | Heizung |
| Pin 2 | Heizung |
| Pin 3 | Sensor + |
| Pin 4 | Sensor - |

Umsetzermodule U15; Kabel für Ausgang

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Steckereinsatz des Verbindungskabels | Stifte |
| Pin 1 | mA Ausgang + für 0-20mA |
| Pin 3 | mA Ausgang - |
| Pin 2 | mA Ausgang + für 4-20 mA |

Anmerkung:

- Die Leitung "Sensor -" hat grundsätzlich Erdpotential.
- Das Verbindungskabel Sensor - Umsetzermodule hat 4 Adern mit 1.5 qmm
Im Bedarfsfall ist der Schirm einseitig am Umsetzermodule PIN 4 anzuschließen
- Verbindungskabel Umsetzermodule - Auswerteelektronik hat Ausgleichsleitung für Pt 10 und 2 mal 1qmm Leiter für Sensorsignal
Im Bedarfsfall ist der Schirm einseitig am Umsetzermodule PIN 4 anzuschließen

7 Technische Daten

Sensor A15-N

| | |
|--------------------------|---|
| Messbereich | 100% bis 10 Exp. -31 bar O ₂ |
| Umgebungstemperatur | -10 bis 70 Grad Celsius |
| Messgenauigkeit | plus/minus 1 mV der Sensor EMK |
| Aufheizzeit des Sensors | ca. 5 Minuten |
| Messgeschwindigkeit | ca. 2 Sekunden |
| Gewicht | ca. 2 kg |
| Maße des Anschlusskopfes | HxBxT 80x120x120 mm |
| Maße des Sensorkörpers | 70 mm Höhe, Durchmesser 50 mm |
| Gewinde für Gaseingang | 3/8 Zoll G |
| Gewinde für Gasausgang | 1/4 Zoll G |

Umsetzermodule Z15

| | |
|--|------------------------|
| Umgebungstemperatur | 10 bis 45 Grad Celsius |
| Versorgungsspannung | 230 V, 50 Hz |
| Leistung | ca. 50 VA |
| Gewicht | ca. 2 kg |
| Maße ohne Befestigungslaschen | HxBxT 80x120x120 mm |
| Grundfläche mit Befestigungslaschen und Steckern | 200x260 mm |

Umsetzermodule Z15-24V

| | |
|--|--|
| Umgebungstemperatur | 10 bis 45 Grad Celsius |
| Versorgungsspannung | 24 VDC, PIN1 = +24V, PIN 2 = -24V |
| Leistung | ca. 50 VA |
| Gewicht | ca. 2 kg |
| Maße ohne Befestigungslaschen | HxBxT 80x120x120 mm |
| Grundfläche mit Befestigungslaschen und Steckern | 200x260 mm |

Umsetzermodule Z15-L/LP

| | |
|--|------------------------|
| Umgebungstemperatur | 10 bis 45 Grad Celsius |
| Versorgungsspannung | 230 V, 50 Hz |
| Leistung | ca. 50 VA |
| Gewicht | ca. 2,5 kg |
| Maße ohne Befestigungslaschen | HxBxT 90x220+120mm |
| Grundfläche mit Befestigungslaschen und Steckern | 300x260 mm |
| Ausgang | 0/4 bis 20 mA |
| Bürde | kleiner 300 Ohm |

Umsetzermodule U15

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Umgebungstemperatur | 10 bis 45 Grad Celsius |
| Versorgungsspannung | 230 V, 50 Hz |
| Leistung | ca.50 VA |
| Gewicht | ca. 2,5 kg |
| Maße ohne Befestigung | HxBxT 110x170x80 mm |
| Grundfläche | 170x80 mm |
| Ausgang | 0/4 bis 20 mA |
| Bürde | kleiner 300 Ohm |